




ARBRE DECISIONNEL DU DEPISTAGE DE L'HOMOCYSTINURIE

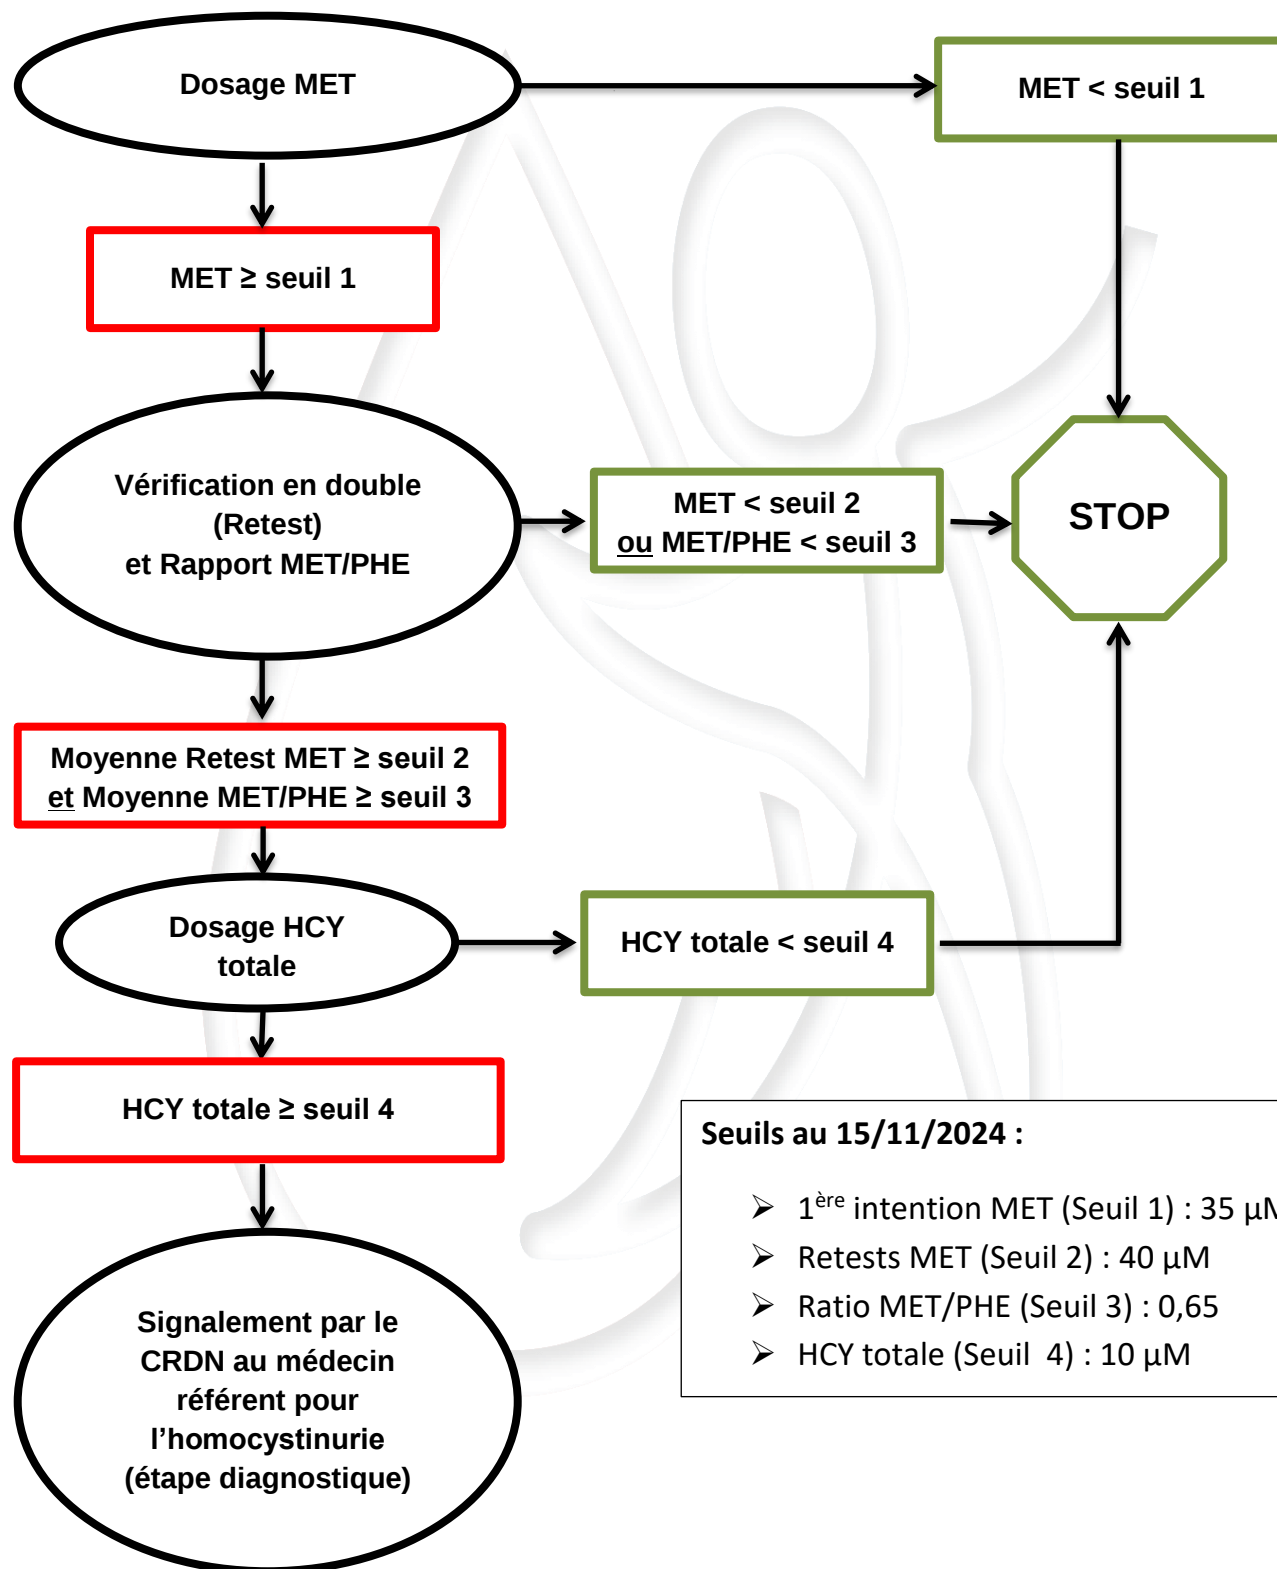

Seuils au 15/11/2024 :

- 1^{ère} intention MET (Seuil 1) : 35 μ M
- Retests MET (Seuil 2) : 40 μ M
- Ratio MET/PHE (Seuil 3) : 0,65
- HCY totale (Seuil 4) : 10 μ M

Centre National de Coordination du Dépistage Néonatal
CNCDN

Hôpital Bretonneau – 2, boulevard Tonnellé – 37044 Tours Cedex 9

Secretariat.cncdn@chu-tours.fr

Tél. : 02.47.47.80.97 – Fax : 02.34.38.95.89